
LAR FLOWSAMPLER POUR ANALYSEUR QuickTOC - DN25

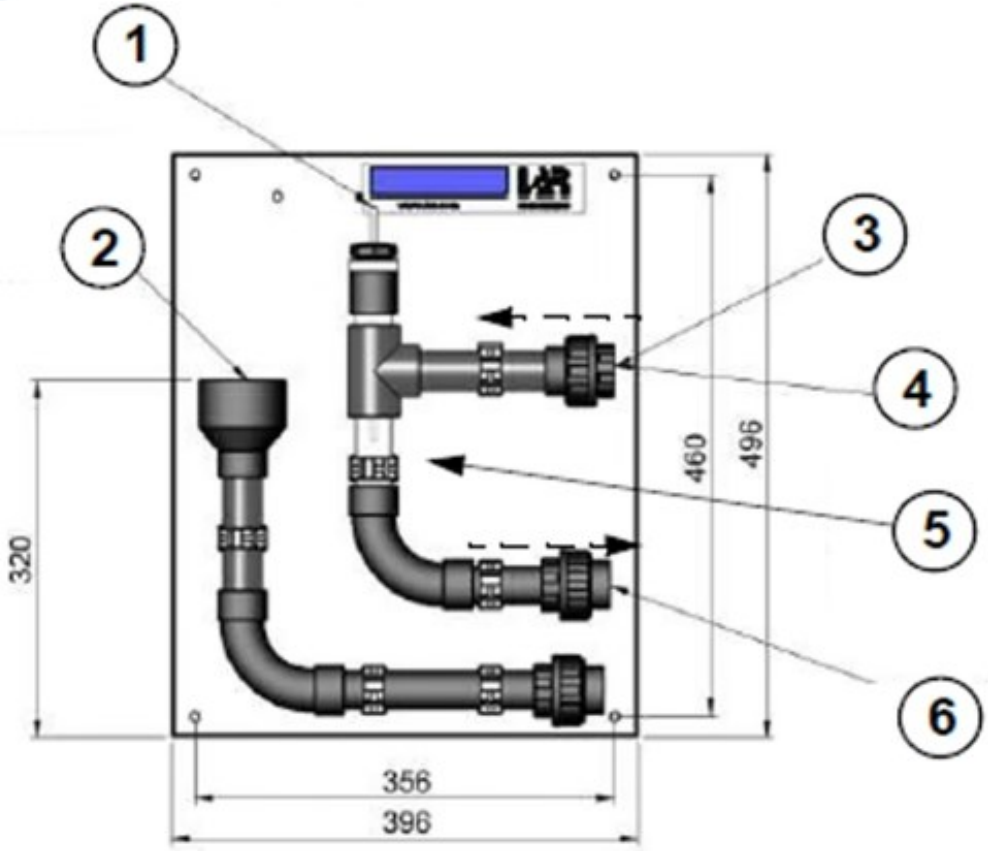


1 Sampling Pipe (Needle)
2 Analyser Outlet (depressurized)
3 Tube fitting (DN25)
4 Sampling Inlet
5 Window
6 Sample Outlet (DN25)

- Raccordement tuyau entrée / sortie diamètre 32mm
- Raccordement tuyau sortie analyseur Diamètre 32mm
- Débit recommandé: 1.0-3.0 m3/h
- Sortie à pression atmosphérique. Max. 0.2b, au besoin augmenter le diamètre du tuyau de sortie

ANAEL
ZI - 15 rue Nobel - 45700 Villemandeur Tel: 02 38 85 77 12 Fax: 02 38 85 99 65
www.analyse-en-ligne.com @: info@analyse-en-ligne.com

LAR FLOWSAMPLER POUR ANALYSEUR QuickTOC - DN17

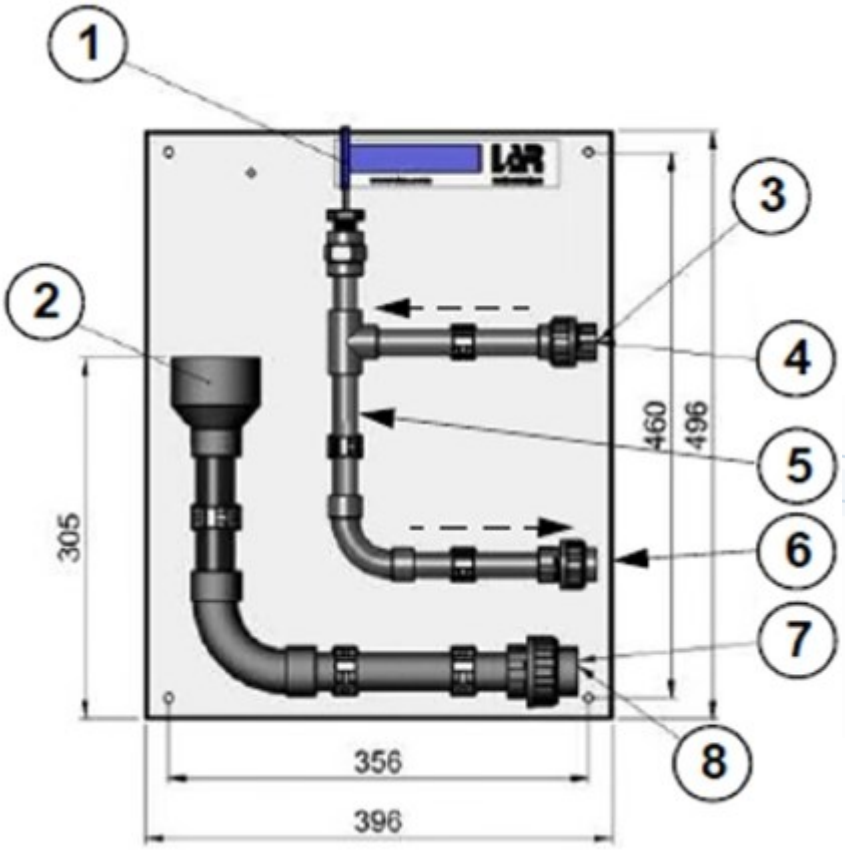

1 Sampling Pipe (Needle)
2 Analyser Outlet (depressurized)
3 Tube fitting (D= 20 mm)
4 Sample Inlet
5 Window
6 Sample Outlet (DA = 20 mm)
7 Tube fitting (DA = 32 mm)
8 Analyser Outlet Out

- Raccordement tuyau entrée / sortie diamètre 20mm
- Raccordement tuyau sortie analyseur Diamètre 32mm
- Débit recommandé: 0.2 - 1.5 m3/h
- Sortie à pression atmosphérique. Max. 0.2b, au besoin augmenter le diamètre du tuyau de sortie

ANAEL
ZI - 15 rue Nobel - 45700 Villemandeur Tel: 02 38 85 77 12 Fax: 02 38 85 99 65
www.analyse-en-ligne.com @: info@analyse-en-ligne.com

LAR FLOWSAMPLER - EXEMPLES DE MONTAGE









ANAEL
ZI - 15 rue Nobel - 45700 Villemandeur ■ Tel: 02 38 85 77 12 Fax: 02 38 85 99 65
■ www.analyse-en-ligne.com ■ @: info@analyse-en-ligne.com